

オキシファーム (OxyFerm) センサーの陰極ラベル追加のお知らせ

お客様各位、

オキシファームシリーズに使用されている陰極に関し、変更についてお知らせいたします。
ハミルトンは、製品トレーサビリティのため、オキシファームシリーズ陰極にラベルを追加しました。
陰極の新しいラベル (図1) は、性能、形状、適合性、または機能に影響を与えません。新しくラベル付けされた陰極は、100%の下位互換性を保証し、元の陰極と同じ仕様を備えています。
この変更は2021年7月8日製造分より適用されます。

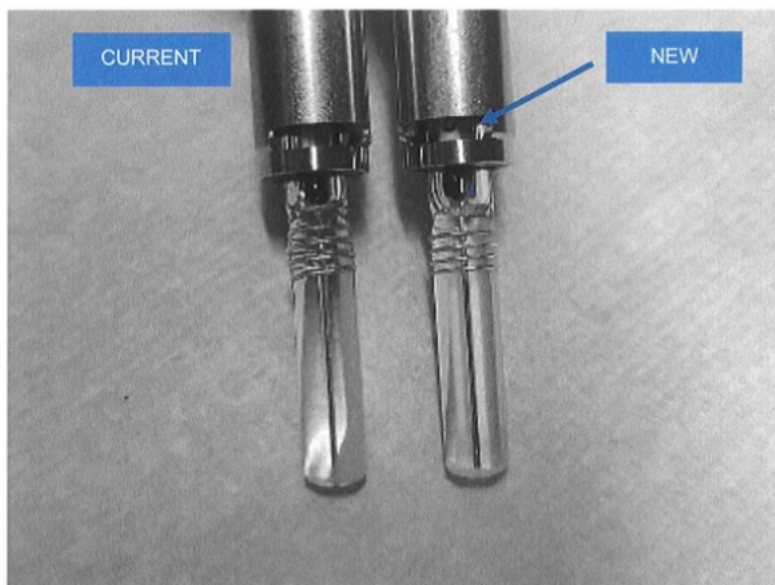


図1 現行品(P/N237306)と新しくラベルが付けられた陰極

対象センサーモデル番号一覧

	a-length	T82	VP 6	Arc	MS
OxyFerm FDA	120	237450	237540	243100	237713
	160	237455	237541	243101	10069701
	225	237452	237542	243102	237715
	325	237453	237543	243103	10069700
	425	237454	237544	243104	-
OxyFerm XL	56	237175-OP	-	243140-OP	-
	125	237170	-	-	-
	262	237174	-	-	-
OxyFerm CIP	120	243289	-	-	-

さらに詳しい情報や参照番号のリストが必要な場合は、スイスもしくは代理店までお問い合わせください。

Product Manager
Christian Adank

Quality Manager
Helen Gartmann Behan