


PC-100/110 簡易設定マニュアル (セカンドモニター機能)



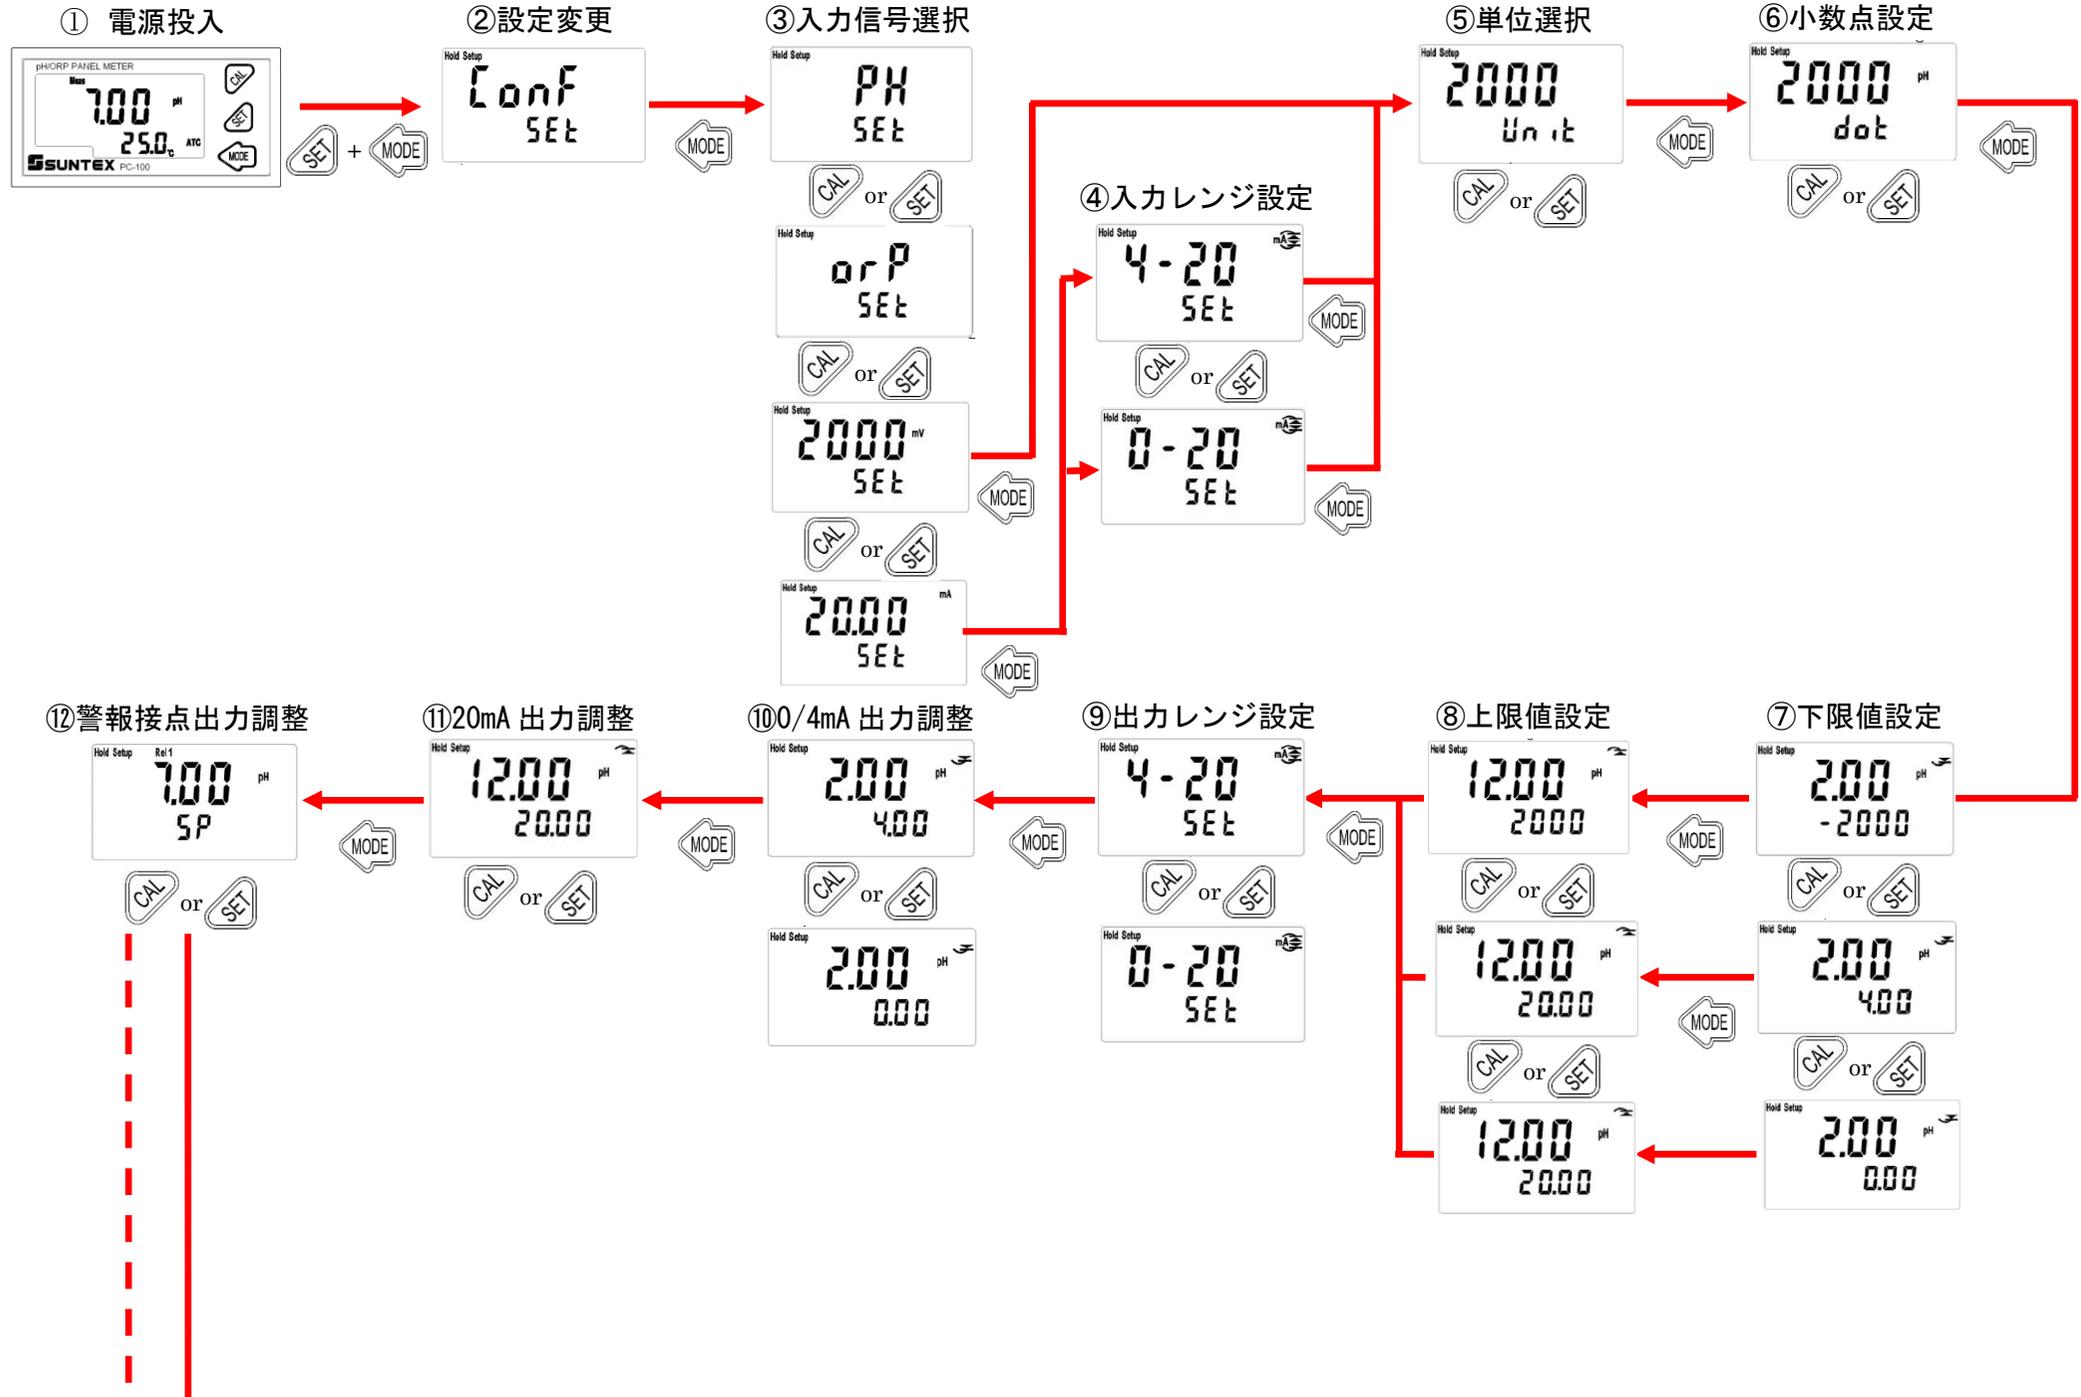

※PC-100 の場合は **---** のように画面移動します。
※間違って設定した場合、測定画面より同じ手順で実行してください。